

# Desinfektion ifm. svælgpodning COVID-19 test


**1** Skru låget på røret




**2** Tør røret med en spritserviet




**3** Sæt røret i beholderen

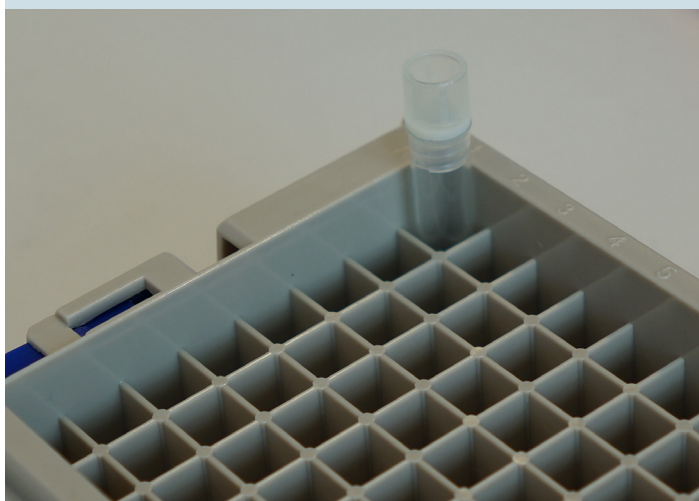

**4** Obs på at låget vender korrekt ved påsætning

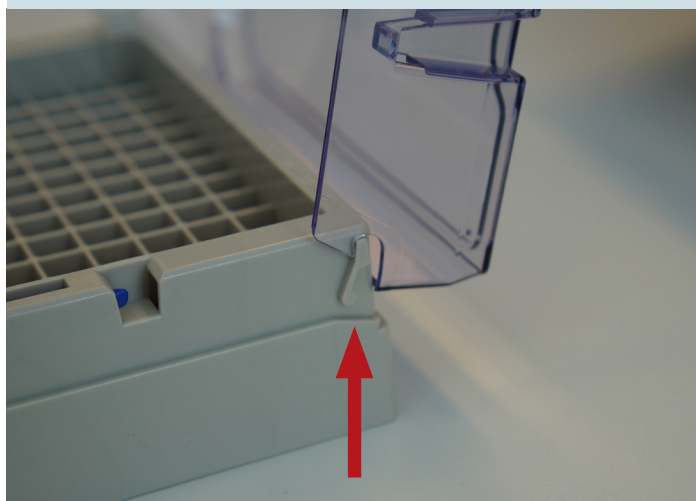

**5** Lås låget, når beholderen er klar

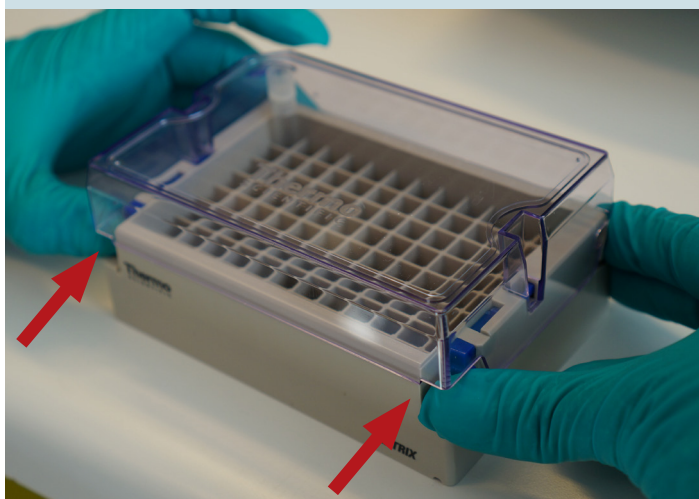

**6** Sprit beholderen af inden den pakkes til transport

